
FICHE PRODUIT

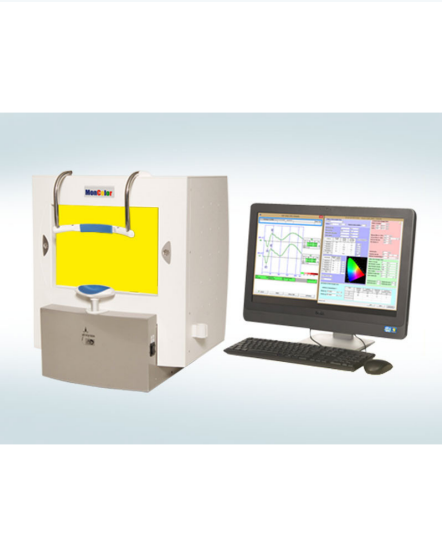

Système d'évaluation de l'électrophysiologie visuelle

Référence : SOC-APS2000AER

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Configuration

- Amplificateur numérique de signal biologique
- Stimulateur programmé de flash et un stimulateur de photo couleur
- Carte A/D électrophysiologique spéciale
- Logiciel spécial pour AVS8000
- Carte de contrôle d'image
- Système informatique
- Imprimante
- Clignotant
- Electrodes

Fonctions

- Potentiels évoqués visuels de flash (PEVF) et d'image (PEVI)
- Électro rétinographie

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Electro-oculographie
- Potentiel évoqué par flash clignotant

Paramètres techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Amplificateur		Stimulateur d'image		Stimulateur de flash	
Fréquence d'émission habituelle	≥120dB	Couleur stimulante	Rouge, Bleu, Jaune, Vert et Blanc	Couleur lumineuse stimulante	Rouge, Bleu, Jaune, Vert et Blanc
Impédance d'entrée	≥100M12PF	Mode de stimulation	Grille d'échiquier, barre debout, matrice et bannière	Fréquence de flash	0.2□30Hz
Bruit du court circuit d'entrée	Vp-p≤2.0	Zones sensibles	Un total de 12 zones comprenant haut/bas, gauche/droite, le centre, le champ complet, le haut, le bas, la gauche, la droite, l'angle supérieur droit, l'angle supérieur gauche, l'angle inferieur droit, l'angle inferieur gauche	Source de stimulation de l'EOG	Lumière rouge de ± 15 degrés et signal sonore
Plus	1□20k 8 niveaux de contrôle programmé	Fréquence des espaces	0.04 ; 0.09 ; 0.19 ; 0.38 ; 0.77 ; 1.55 ; 3.10	Force du flash (cd*s/m^2)	$6.325e^{4}$ $1.125e^{-3}$ $2.000e^{-3}$ $3.556e^{-3}$ $6.325e^{-3}$ $1.125e^{-2}$ $2.000e^{-2}$ $3.556e^{-2}$ $6.325e^{-2}$ $1.125e^{-1}$ $2.000e^{-1}$ $3.556e^{-1}$ $6.325e^{-1}$ 1.125 2.000
Bande de fréquence	0.1□500Hz 8 niveaux de contrôle programmé	Comparaison par paire	40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%	Eclat de la lumière de fond (cd/m^2)	0.949, 1.687, 3.000, 5.335, 9.487, 16.870, 30.000

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/9553-systeme-d-evaluation-de-l-electrophysiologie-visuelle.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.